



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ЭТАЛОН И ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ УГЛА СДВИГА ФАЗ
В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ
 $25,95 - 37,50$ ГГц

ГОСТ 8.533-85

Издание официальное

Цена з. коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСТ
ГОСТ

ГОСТ 8.533-85, Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверка ...
State system for ensuring the uniformity of measurements. State special standard and state verification schedule for means measuring phase shift angle with in

**РАЗРАБОТАН Государственным комитетом СССР по стандартам
ИСПОЛНИТЕЛИ**

Р. М. Тигранян, канд. техн. наук (руководитель темы); П. М. Герунн,
д-р техн. наук; Р. Р. Казарян, канд. техн. наук

ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам

Член Госстандарта Л. К. Исаев

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государствен-
ного комитета СССР по стандартам от 17 октября 1985 г. № 117

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Государственная система обеспечения единства измерений

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН И
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА
ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ УГЛА СДВИГА ФАЗ
В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ $25,95 \div 37,50$ ГГц**

State system for ensuring the uniformity of measurements. State special standard and state verification schedule for means measuring phase shift angle within the frequency range from 25,95 to 37,50 GHz

ОКСТУ 0008

**ГОСТ
8.533—85**

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 октября 1985 г. № 117 срок введения установлен

с 01.01.87

Настоящий стандарт распространяется на государственный специальный эталон и государственную поверочную схему для средств измерений угла сдвига фаз в диапазоне частот $25,95 \div 37,50$ ГГц и устанавливает назначение государственного специального эталона единицы угла сдвига фаз — градуса (\dots°) в диапазоне частот $25,95 \div 37,50$ ГГц, комплекс основных средств измерений, входящих в его состав, основные метрологические характеристики эталона и порядок передачи размера единицы угла сдвига фаз в диапазоне частот $25,95 \div 37,50$ ГГц от государственного специального эталона при помощи вторичных эталонов и образцовых средств измерений рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов поверки.

1. ЭТАЛОНЫ**1.1. Государственный специальный эталон**

1.1.1. Государственный специальный эталон предназначен для воспроизведения и хранения единицы угла сдвига фаз в диапазоне частот $25,95 \div 37,50$ ГГц и передачи размера единицы при помощи вторичных эталонов и образцовых средств измерений рабочим средствам измерений, применяемым в народном хозяйстве с целью обеспечения единства измерений в стране.

1.1.2. В основу измерений угла сдвига фаз электромагнитных колебаний в диапазоне частот $25,95 \div 37,50$ ГГц в волноводных

Издание официальное**Перепечатка воспрещена****© Издательство стандартов, 1986**

трактах должна быть положена единица, воспроизводимая указанным эталоном.

1.1.3. Государственный специальный эталон состоит из комплекса следующих средств измерений:

волноводный плавный фазовращатель телескопического типа; набор волноводных отрезков сечением $7,2 \times 3,4$ мм;

компаратор, включающий фазовый мост, тройник, волноводный тракт, опорные элементы, специальные генераторы, индикаторы и частотомер.

1.1.4. Диапазон значений угла сдвига фаз в диапазоне частот $25,95 \div 37,50$ ГГц, воспроизводимых эталоном, составляет $0 \div 360^\circ$.

1.1.5. Государственный специальный эталон обеспечивает воспроизведение единицы со средним квадратическим отклонением результата измерений S , не превышающим $0,1^\circ$ при десяти независимых наблюдениях. Неисключенная систематическая погрешность Θ не превышает $0,2^\circ$.

1.1.6. Для обеспечения воспроизведения единицы угла сдвига фаз в диапазоне частот $25,95 \div 37,50$ ГГц с указанной точностью должны быть соблюдены правила хранения и применения эталона, утвержденные в установленном порядке.

1.1.7. Государственный специальный эталон применяют для передачи размера единицы угла сдвига фаз в диапазоне частот $25,95 \div 37,50$ ГГц вторичным эталонам непосредственным сличением.

1.2. Вторичные эталоны

1.2.1. В качестве рабочих эталонов применяют комплексы средств измерений, аналогичные по составу государственному специальному эталону.

1.2.2. Средние квадратические отклонения результатов сличений S_2 рабочих эталонов с государственными не должны превышать $0,3^\circ$.

1.2.3. Рабочие эталоны применяют для передачи размера единицы образцовым и рабочим средствам измерений методом прямых измерений и сличением при помощи компаратора.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. В качестве образцовых средств измерений применяют образцовые волноводные фазовращатели.

2.2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Δ образцовых средств измерений не должны превышать $2,5^\circ$.


2.3. Образцовые средства измерений применяют для поверки рабочих средств измерений сличением при помощи компаратора и методом прямых измерений.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют фазо-вращатели и фазометры.

3.2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Δ рабочих средств измерений составляют от 2,5 до 10°.

**Государственная поверочная схема для средств измерений угла сдвига фаз
в диапазоне частот 25,95–37,50 ГГц**

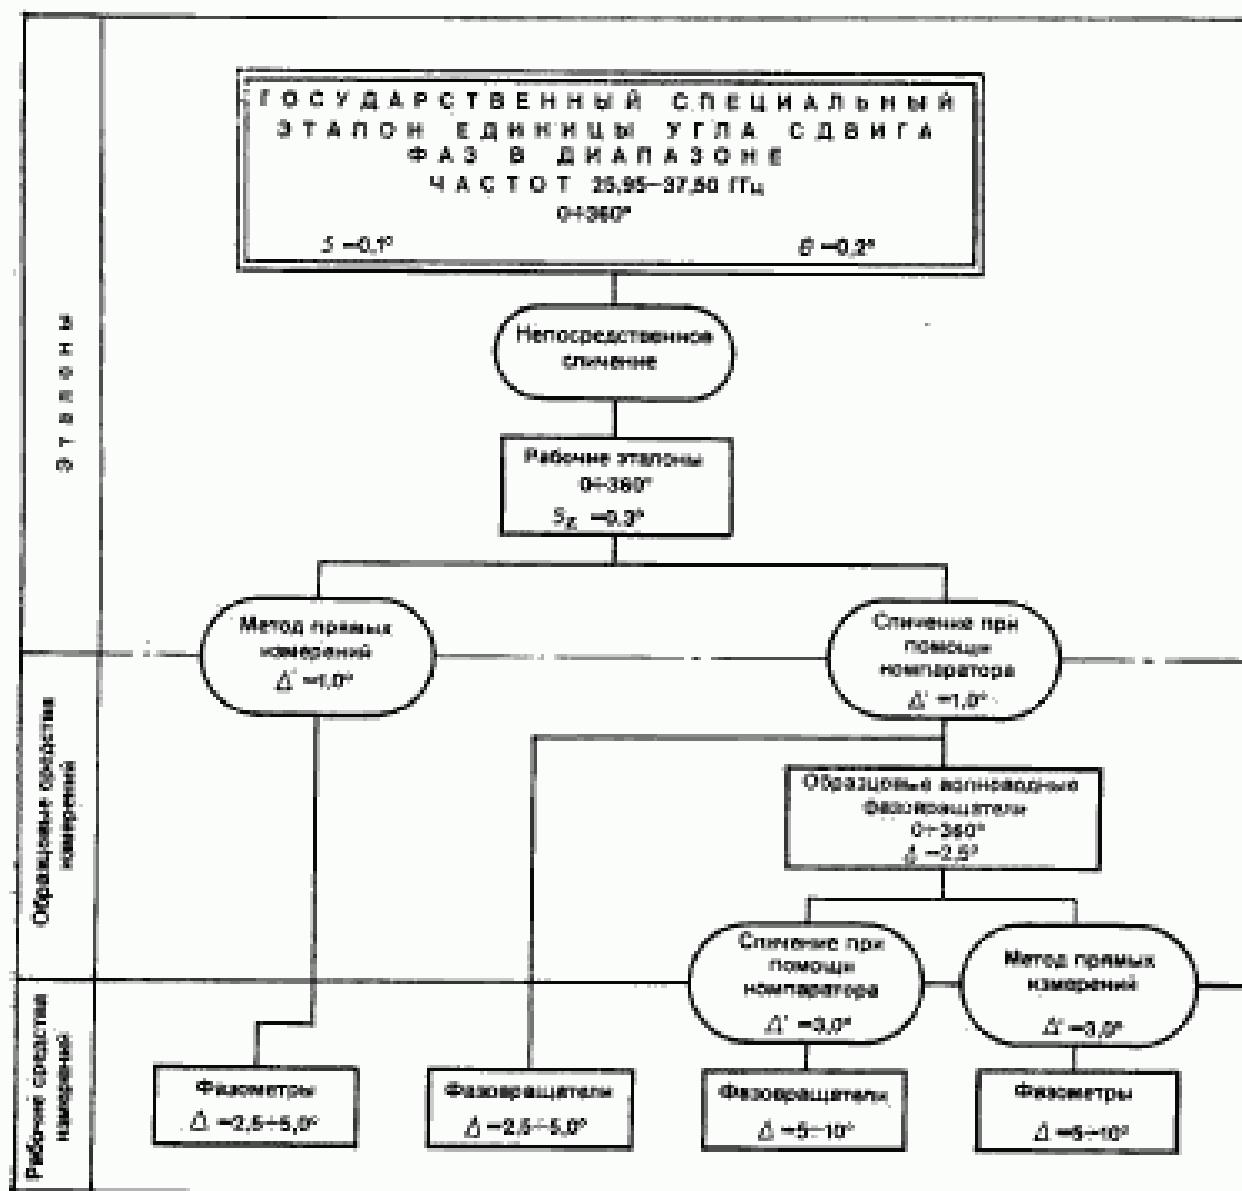

Δ' — Погрешность передачи размера единицы

Редактор М. В. Глушкова
Технический редактор М. И. Максимова
Корректор А. С. Черноусова

Сдано в наб. 06.12.85 Подп. в печ. 13.01.86 0,5 усл. л. л. 0,5 усл. кр.-отт. л. 24 уч.-изд. л.
Тираж 16 000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 9
Тип. «Московский типография», Москва, Лигин пер., 6 Зак. 1576



ГОСТ 8.533-85, Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверка ...
State system for ensuring the uniformity of measurements. State special standard and state verification schedule for means measuring phase shift angle with in